

1

3


4

5

Rete Monitoraggio CG PAUTE CONSEJO DE GESTION DE AGUAS DE LA CUENCA DEL PAUTE



PROGETTO ESECUTIVO ST42 Sonda Multiparametrica

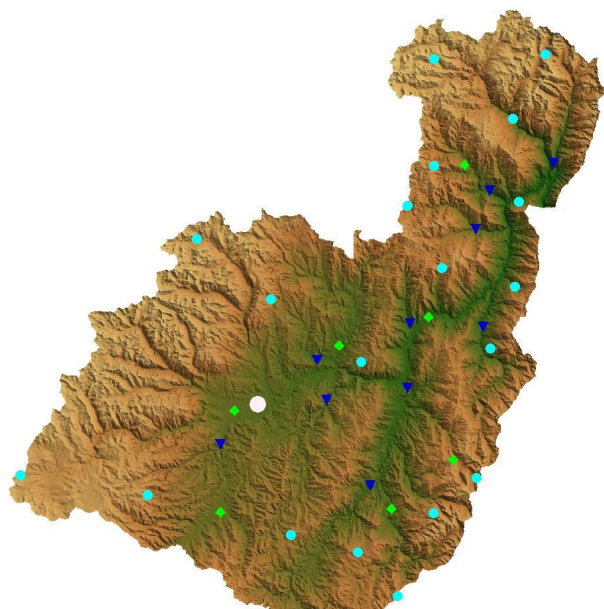

Commessa: 080071-A

Impianto: a322a

SIAP+MICROS		080071-A
PROGETTO	DATA	APPARECCHIATURA
Cancian Ivo	25-02-08	Progetto
DISEGNO	DATA	st42
Cancian Ivo	25-02-08	
VERIFICA	DATA	FOGLIO 1 DI 3
	25-02-08	FILE: a252a-g161-st01-dw.sdr

1

2

3


4

5

STAZIONE : ST42

Codici Misura


- 21-Temperatura acqua (°C)
- 22-Conducibilità calibrata (µS/cm)
- 23-PH calibrata (pH)
- 24-Redox calibrata (mVolt)
- 25-Ossigeno calibrata (%)
- 26-Torbidità (NTU)

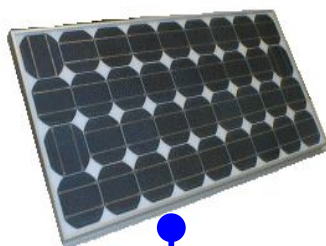

Trasmissione Dati e-mail





Cod. SA8065.104 Sonda Multiparametrica della B&C per : Livello, Temperatura, Conducibilità, Ph, Redox, Ossigeno disciolto

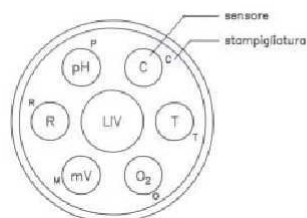

VISTA LATO SENSORI

SIGLA	SENSORE	SIMBOLO
LIV	livello	P
pH	pH	R
R	riferimento	M
mV	redox	O
O ₂	ossigeno d.	T
T	temperatura	C
C	conducibilità	

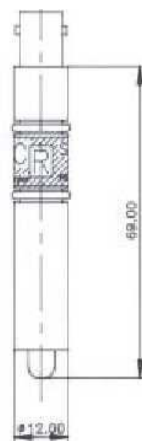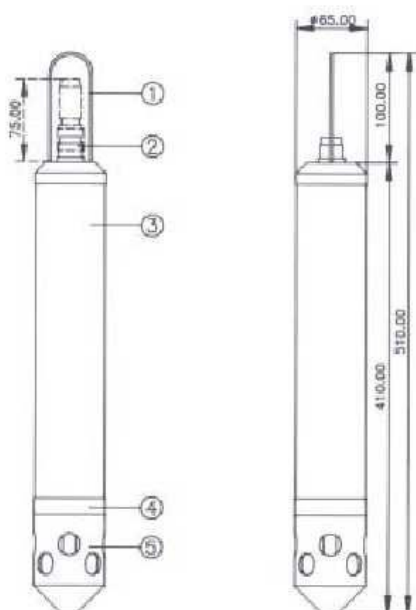

Cod	Descrizione	Simbolo
SA9100	Elettrodo di Riferimento	R
SA9110	Elettrodo di misura pH	P
SA9120	Elettrodo di misura redox	M
SA9130	Cella di conducibilità	C
SA9150	Sensore di temperatura	T
SA9160	Cella di misura Ossigeno disciolto	O

1. GANCIO SICUREZZA
2. CONNETTORE
3. CORPO SONDA
4. ALLOGGIAMENTO SENSORI
5. TUBO FORATO

[illegible]